

第 4 回 九州医用画像コミュニティのご案内

拝啓 初夏の候、皆様方におかれましては、益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。

先般、数十年に一度の豪雨により延期となりました第 4 回九州医用画像コミュニティを下記の要領で開催いたしますのでご案内申し上げます。

今回は、脊椎診療における画像評価の役割、新しい全脊椎 X 線撮影装置や骨構造の定量的評価法に焦点を当てた講演となっています。

ご多忙中とは存じますが皆様のご参加をお願いいたします。

敬具

代表世話人 産業医科大学病院
村上 誠一


記

開催日 : 平成 30 年 9 月 15 日 (土曜日)
時 間 : 14:00~18:00 受付 13:15~
会 場 : (株) アステム福岡 (福岡市博多区吉塚 6-15-11 吉塚駅より徒歩 5 分)
参加費 : 500 円 (ただし、日本放射線技術学会の会員は無料)

プログラム

- I. **メーカー講演 14:00~14:40** 司会 福岡大学病院 上野 登喜生
「 最新型 超低線量全身 X 線撮影装置 sterEOS イメージングシステムについて 」
エダップテクノメド株式会社 EOS 事業部 大山 智之 氏
- II. **特別講演 14:55~15:55** 司会 産業医科大学病院 村上 誠一
「 脊椎診療における画像評価の役割 ～医師が観(診)ているものは? 」
講師: 産業医科大学 整形外科学 准教授 中村 英一郎 先生
- III. **テーマ討論 16:10~17:50** 司会 久留米大学医学部 片山 礼司
産業医科大学病院 高木 剛司
「 骨構造解析について 」
1) Dixon 変法を用いた骨強度推定の検討 産業医科大学病院 片山 竜也 氏
2) トモシンセシスによる骨梁パターンのテクスチャ解析について
(株)島津製作所 医用技術部 アプリケーショングループ 西野 和義 氏
3) 2 種類の X 線検出部を積層した「デュアル構造」FPD について
富士フィルムメディカル株式会社 坂本 真俊 氏
- IV. **ワンポイントアドバイス 17:50~18:00**
皆様の施設で困っていることなどを参加者と一緒に考えてみませんか?
当日、受付で申し込み可能です。

台風や豪雨等により開催不可能と判断した際は、中止情報を HP に掲載しますので確認をお願い致します。

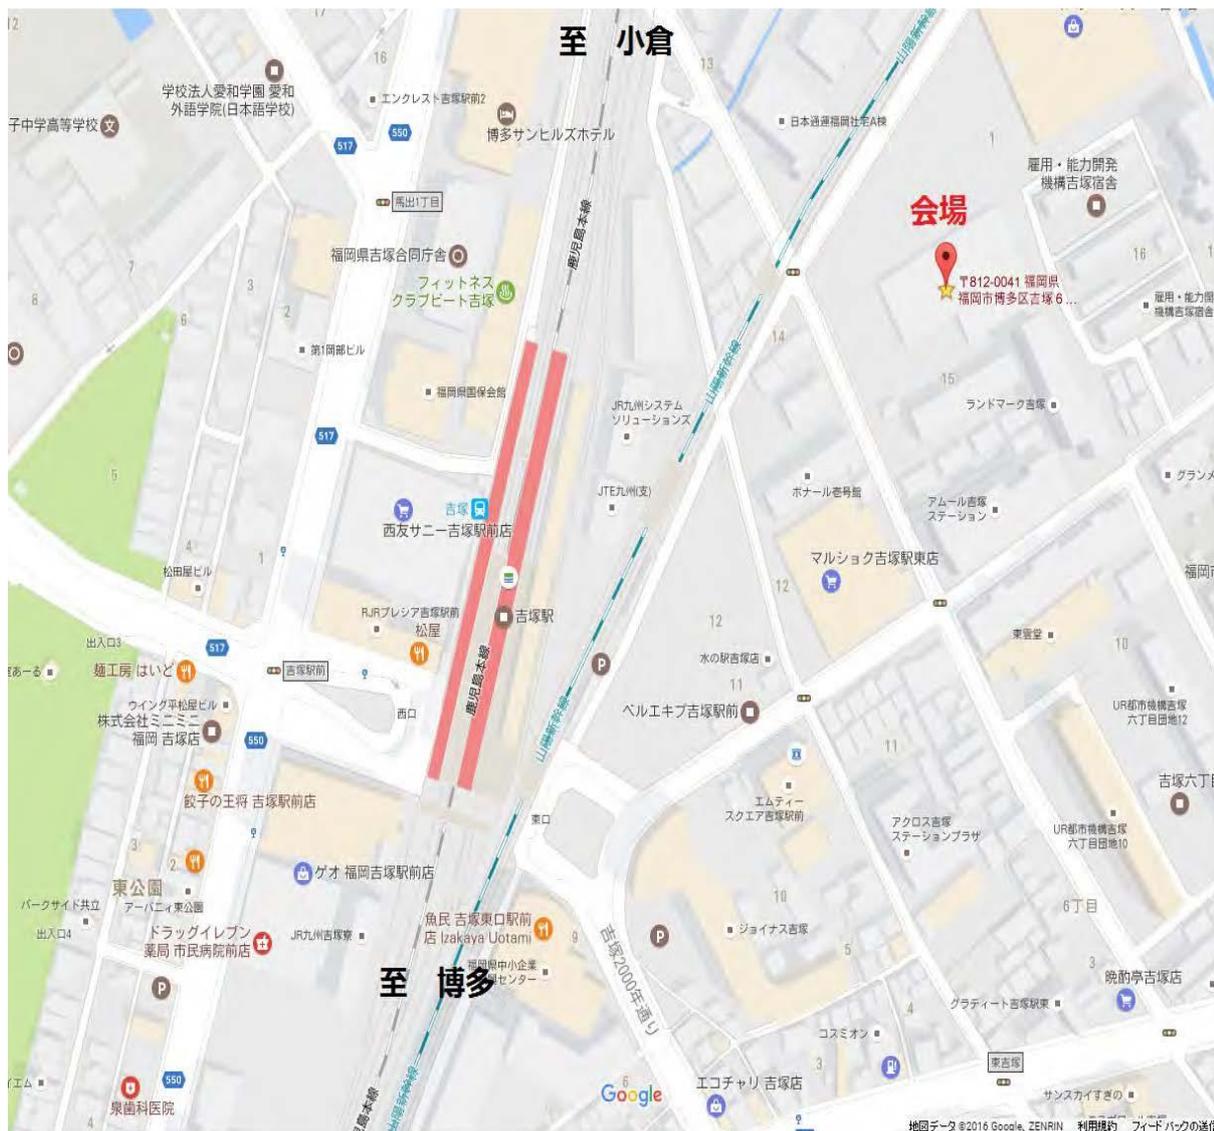

※会場近くに同じ社名でOA機器の「株式会社アステム」がありますのでご注意ください。

※会場には、駐車場がありませんので公共交通機関をご利用ください。